


03-5

1 300mg 3 6 1

Image




Image

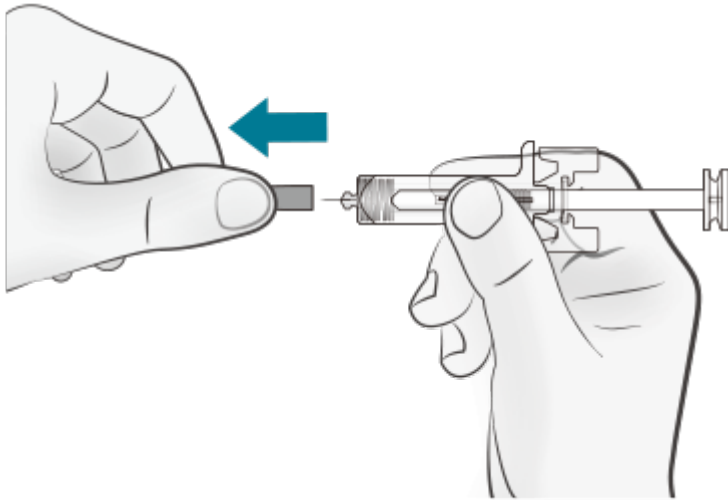

3


45

Image

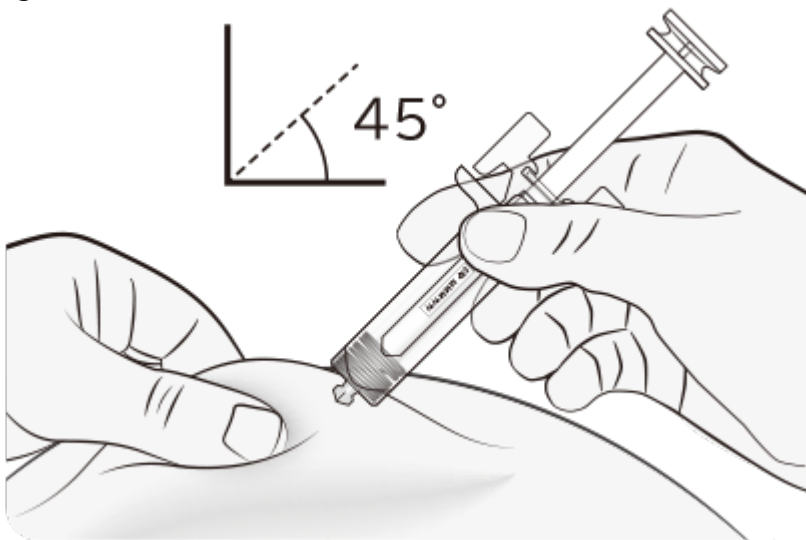

4


Image

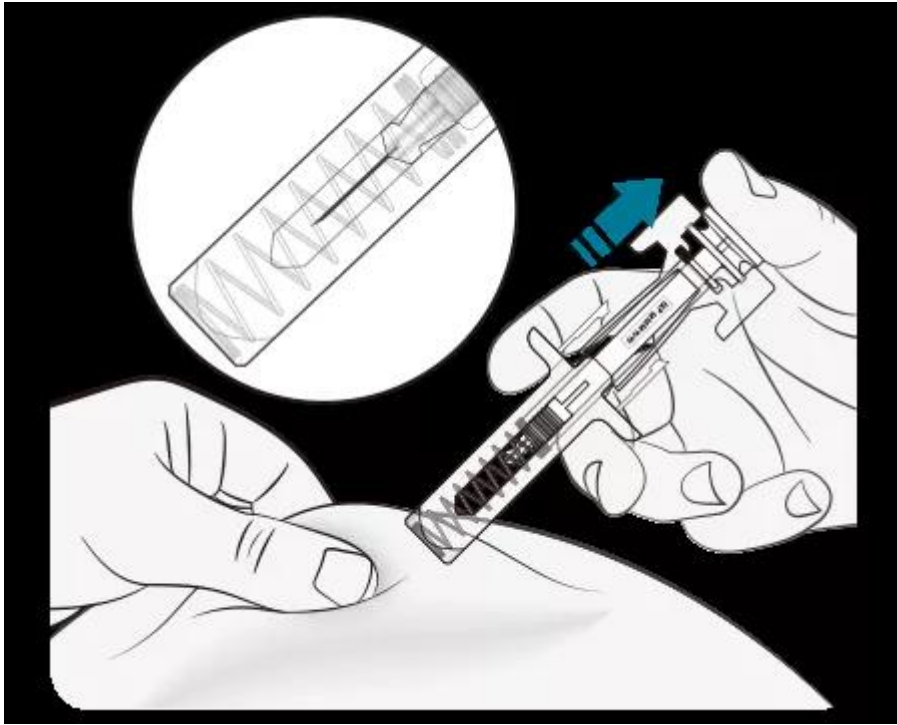

7



当初のスケジュール

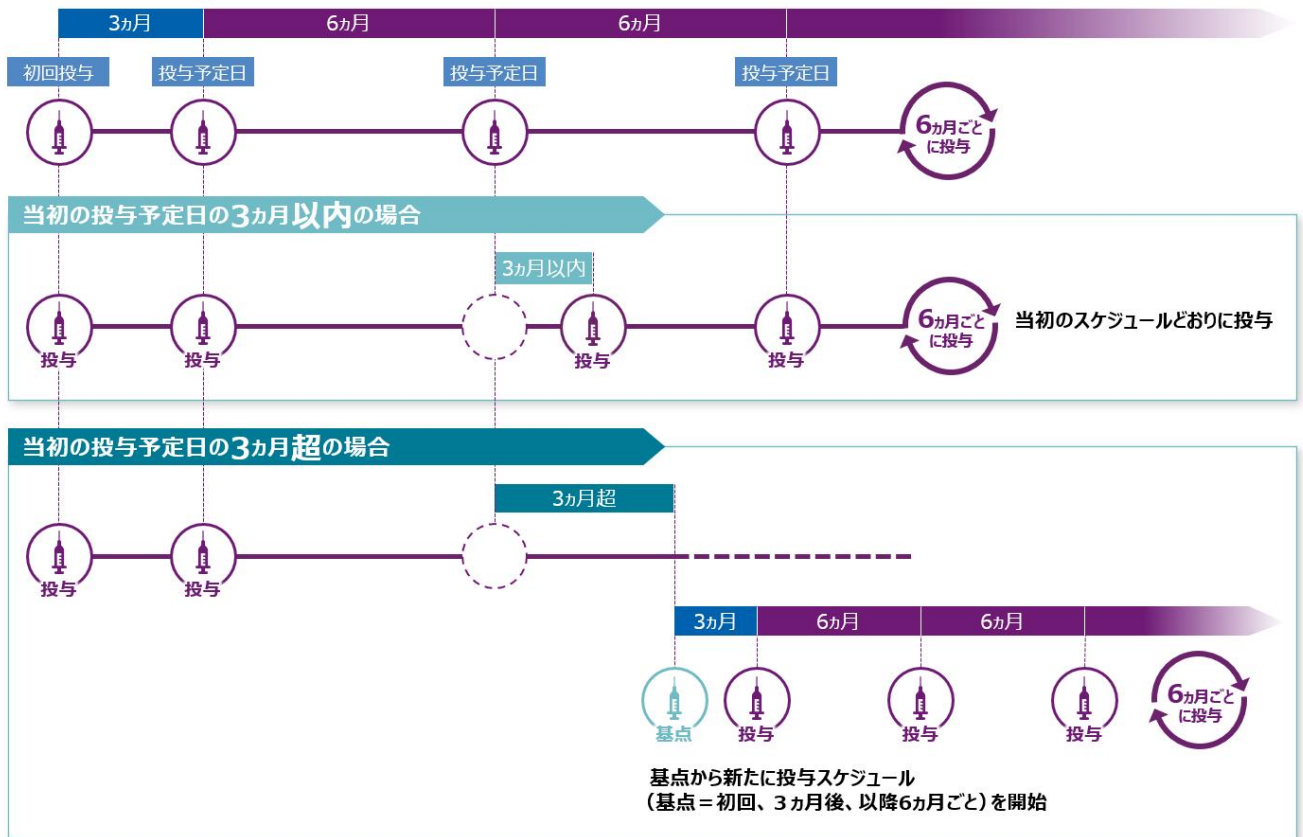


□□□□□□□□□□

- 00000000000000000000000000000000
- 00010000000000000000000000000000
- 00000100000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000

Image



□□□□

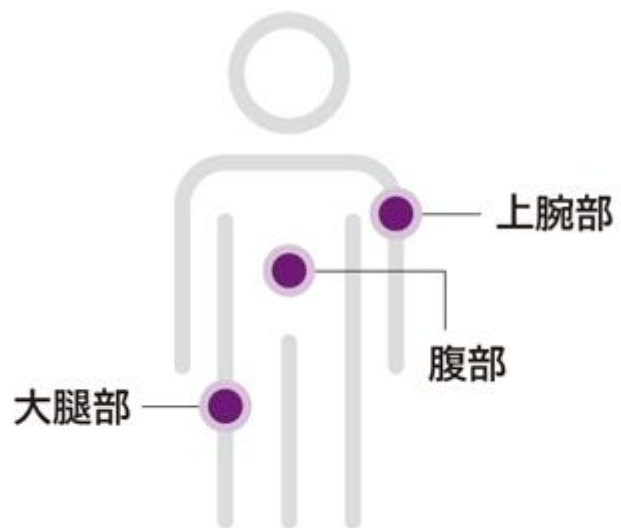

□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

⚠ 本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

使用前

使用后

- 外箱やプラスチックトレイの封が破れている場合は、プレフィルドシリンジを使用しないでください。
- 注射の準備が整うまで注射針カバーを外さないでください。
- プレフィルドシリンジを硬い所に落とした場合や、注射針カバーを外した後に落とした場合は、使用しないでください。

- プレフィルドシリンジの再使用や分解はしないでください。
- プレフィルドシリンジには、注入完了後に注射針を覆う針ガードがついています。この針ガードにより、注射後の針刺し事故を防ぎます。

□□□□□□

レクビオ[®]皮下注 300mgシリンジ 投与ガイド

300mgシリンジ




レクビオの投与にあたって

- ※ 本剤の投与にあたっては、医師・看護師等の適切な指導を受けなければなりません。
- ※ 本剤は1回投与量を全量吸入したプレフィルドシリンジです。シリンジは1回のみ使用してください。
- ※ 本剤は、室温で保存してください。
- ※ 本剤は、他の一環剤との相互作用はありません。

レクビオの投与部位

- ※ 本剤は、皮下にのみ投与してください。
- ※ 注射が可能な部位は腹部、上腕部又は大腿部です。

警告
ゼンパレン[®]、薬物、食物、皮膚感染症等、
注射部位の皮膚感染症や損傷がある部位には
注射しないでください。



プレフィルドシリンジの構造及び名称

- ※ 本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

- ※ 本剤はガラスシリンジにプレフィルドシリンジを挿入して使用してください。
- ※ プレフィルドシリンジを破損に露せしめず、注射針のバーを挿入する際と露せしめず、使用しないでください。
- ※ プレフィルドシリンジの構造図や詳細図を参照してください。



NOVARTIS



Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/leqvio/about/administration>