


03-5


1 300mg 3 6 1

Image



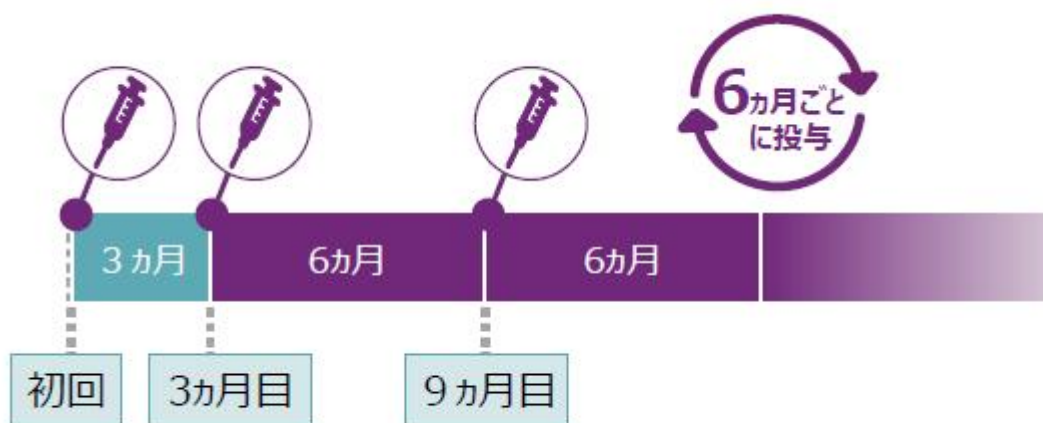


Image

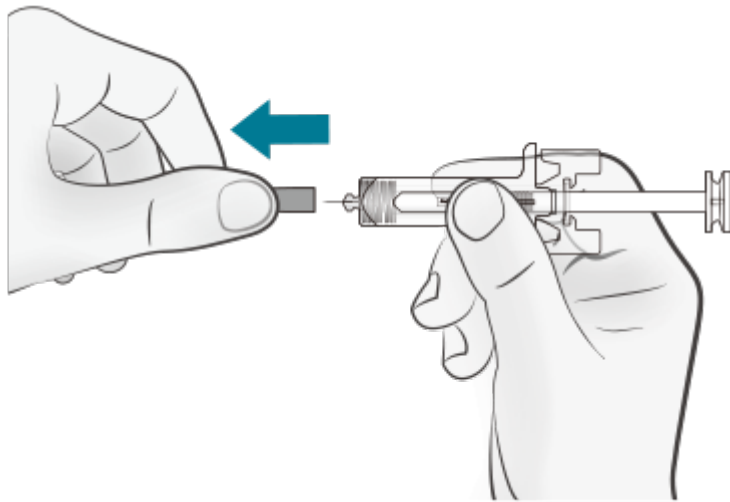

3

45


Image

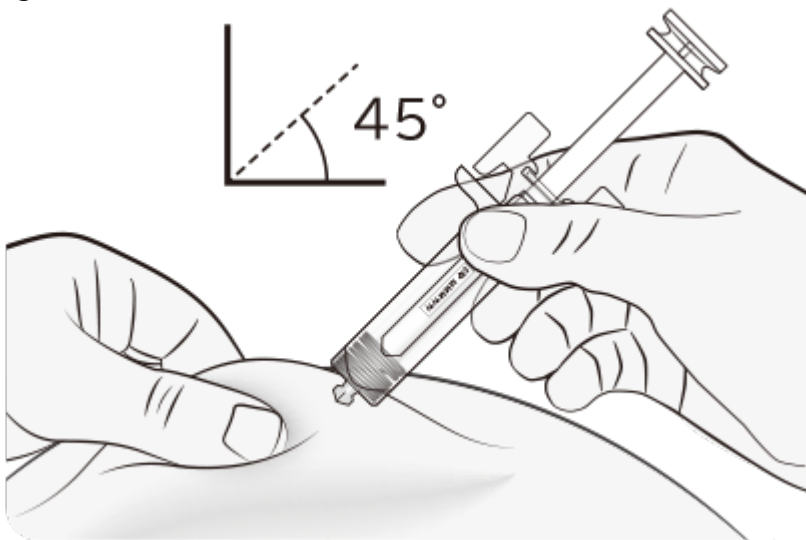

4

Image



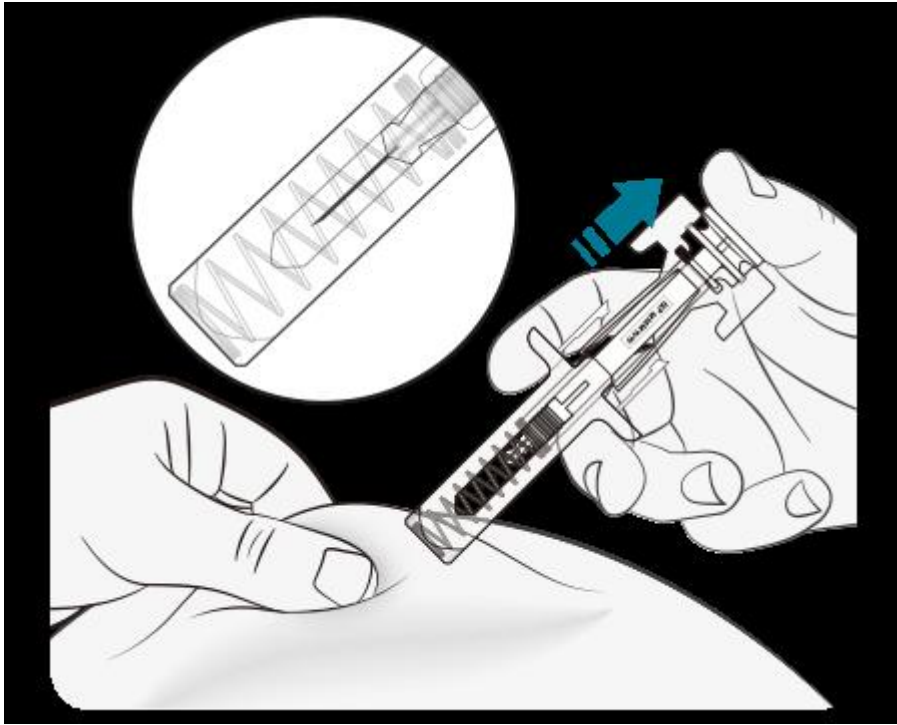


7





### 当初のスケジュール

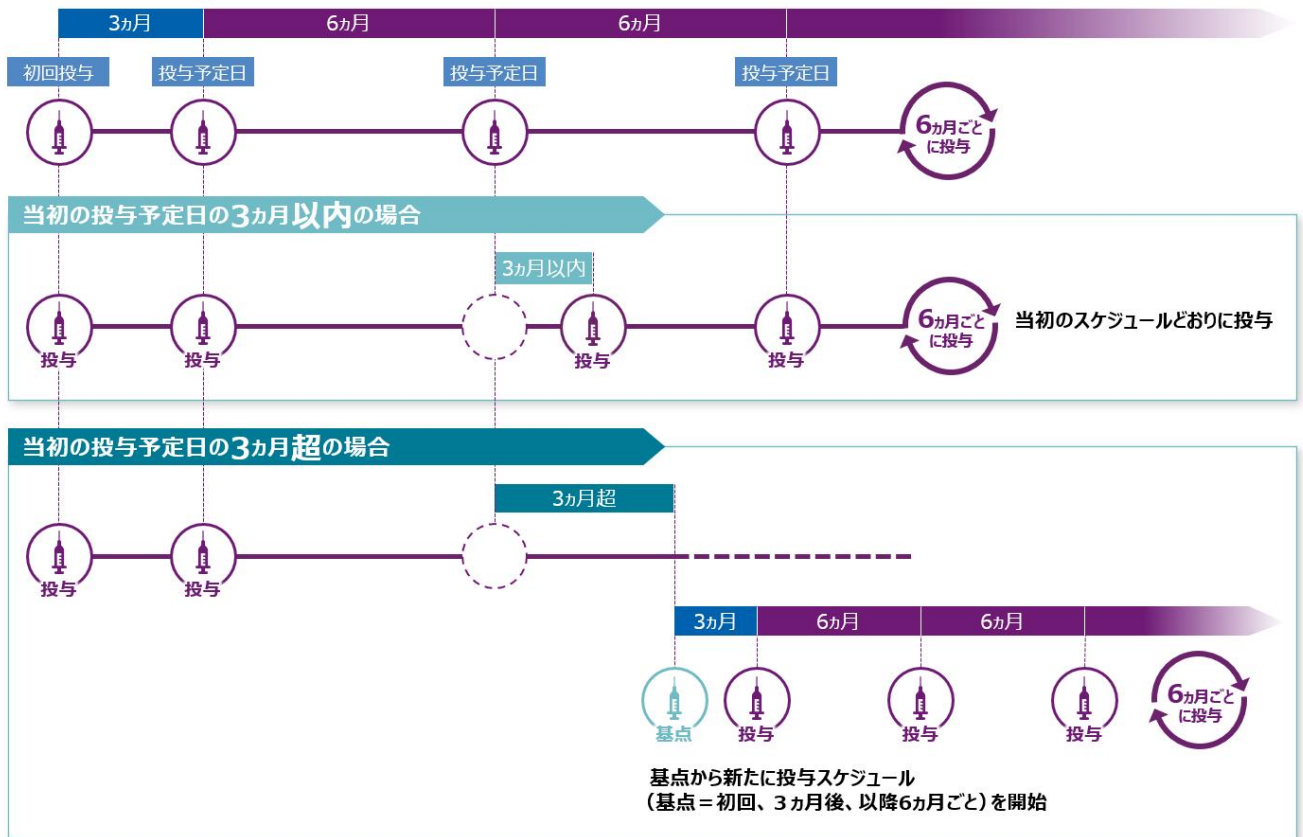

□□□□□□□□□□

- 00000000000000000000000000000000
- 00010000000000000000000000000000
- 00000100000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000


Image





□□□□



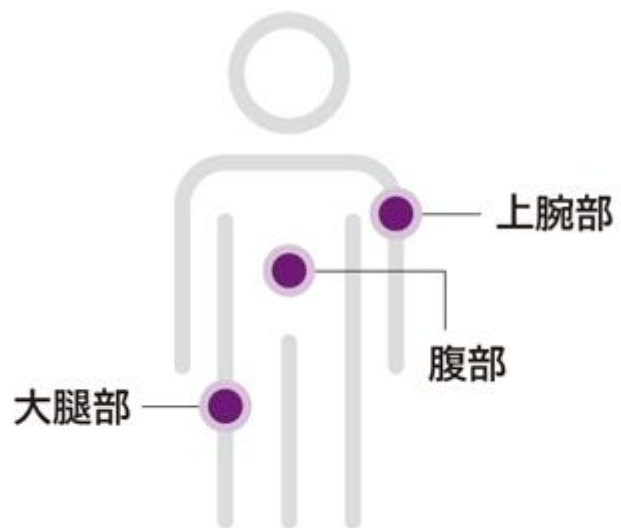

□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

⚠ 本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

**使用前**

- 外箱やプラスチックトレイの封が破れている場合は、プレフィルドシリンジを使用しないでください。
- 注射の準備が整うまで注射針カバーを外さないでください。
- プレフィルドシリンジを硬い所に落とした場合や、注射針カバーを外した後に落とした場合は、使用しないでください。

**使用后**

- プレフィルドシリンジの再使用や分解はしないでください。

● プレフィルドシリンジには、注入完了後に注射針を覆う針ガードがついています。この針ガードにより、注射後の針刺し事故を防ぎます。

□□□□□□



# レクビオ<sup>®</sup>皮下注 300mgシリンジ 投与ガイド

NOVARTIS




## レクビオの扱いに当たって

- ※ 本剤は凍結させず、室温（室温中での凍結は避けてください）で保存してください。
- ※ 本剤は1回投与量を含むフルフィルドシリンジです。シリンジは1回のみ使用してください。
- ※ 本剤は、室温で保存してください。
- ※ 本剤は、他の一環包装の薬物とは異なります。

## レクビオの投与部位

- ※ 本剤は、皮下にのみ投与してください。
- ※ 注射可能な部位は腹部、上腕部又は大腿部です。

警告  
 センチール<sup>®</sup>、皮膚、炎症、皮膚感染症、  
 注射部位の腫脹感や疼痛がある部位には  
 注射しないでください。



## プレフィルドシリンジの構造及び名称

- ※ 本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

- ※ 本剤はガラスシリンジに凍結防止剤（ブドウ糖）を配合しています。
- ※ プレフィルドシリンジを凍結させないでください。凍結したシリンジは廃棄してください。
- ※ プレフィルドシリンジの構造図を参照してください。



NOVARTIS



Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/leqvio/about/administration>