

視力検査の方法

検査距離

検査用文字


検査用文字の大きさ

検査用文字の位置

- 視力検査の方法

5m 0.2 0.3 4m 0.3 0.24

Image

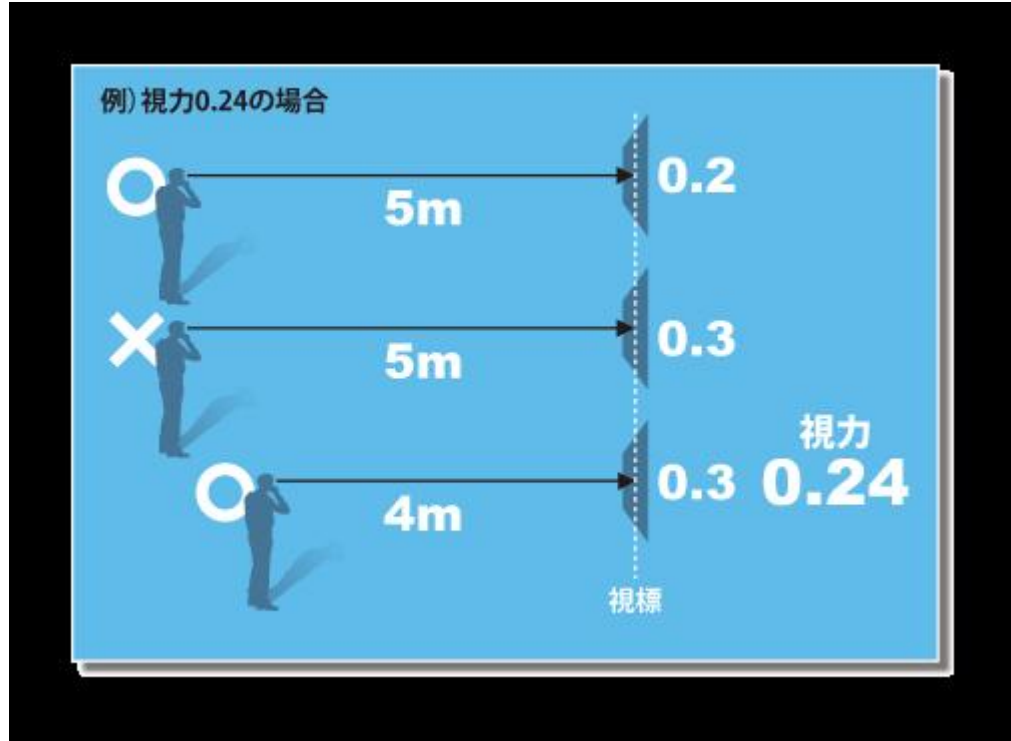

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Image

測定距離 5m	測定距離	視標	詳細な視力 (理論値)
0.1	1m	0.1	(0.02)
0.2	1.5m		(0.03)
0.3	2m		(0.04)
0.4	2.5m		(0.05)
0.5	3m		(0.06)
0.6	4m		(0.08)
0.7	3m	0.2	(0.12)
0.8	4m		(0.16)
0.9	4m	0.3	(0.24)
1.0			
1.2			
1.5			
2.0			

□□□□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/patienttool>